

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度、下記項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 検査内容変更項目

コード No.	検査項目	変更箇所	新	旧	備考
825	神経特異エノラーゼ (NSE)	基準範囲	12.0 ng/ml 以下	16.3 ng/ml 以下	国内における健常者を対象 (試薬メーカー推奨値)  裏面参照
23	活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APTT)	基準範囲	測定秒数 (25.0~35.0 秒)	測定秒数 (25.0~35.0 秒) 活性値 (70~120%)	評価しやすい秒数のみの 報告とする

### 変更期日


- 平成21年 1月26日(月) 受付分より



## 「参考資料」

### 弊社職員健康診断データにおけるNSEのヒストグラム

2008年11月

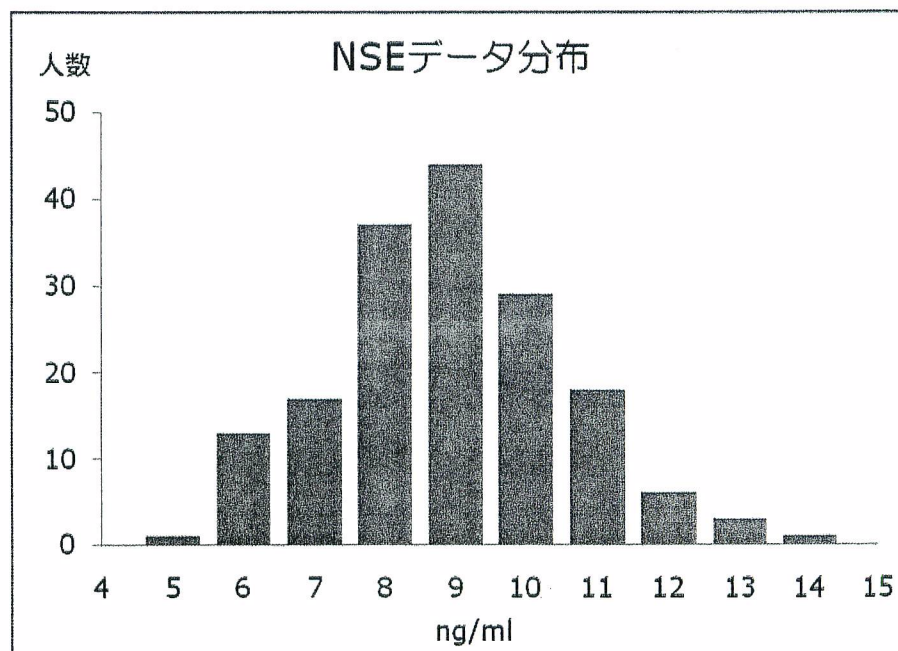

男性 78例  
女性 91例

---

計 169例

試薬メーカー推奨値である 12.0ng/ml を超えたものは 169 例中 7 例 (4%) でした