



検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

検査内容変更項目

- 別掲の一覧表をご参照下さい。




実施期日

- 平成 21 年 4 月 1 日(水)受付より

検査内容変更項目一覧

コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考 (検査案内掲載頁)
346	AST(GOT)	単位	U/l	IU/l	報告単位の見直し (11 頁)
347	ALT(GPT)				
348	LD(LDH)				
345	ALP				
353	LAP				
350	γ-GT				
354	CK				
364	リパーゼ				
362	総酸性フォスファターゼ				
395	前立腺酸フォスファターゼ				
660	アデニンデアミナーゼ				報告単位の見直し (12 頁)
351	コリンエステラーゼ	基質	p-ヒドロキシベンゾイル コリン (JSCC 標準化対応法)	ヨウ化ブチリルチオコリン	JSCC 標準化に対応 (11 頁)
		基準範囲	213 ~ 501	3600 ~ 7600	
		単位	U/l	IU/l	
367	血清アミラーゼ	基質	Et-G7-pNP (JSCC 標準化対応法)	G3-CNP	
		基準範囲	37 ~ 125	40 ~ 160	
		単位	U/l	IU/l	
368	尿アミラーゼ	基質	Et-G7-pNP (JSCC 標準化対応法)	G3-CNP	
		基準範囲	76 ~ 438	40 ~ 700	
		単位	U/l	IU/l	
377	尿糖定量	基準範囲	20 以下	設定なし	測定感度の向上 報告単位の見直し 基準範囲の設定 (15 頁)
		単位	mg/dl	g/dl	
379	尿糖(負荷)	基準範囲	20 以下	設定なし	
		単位	mg/dl	g/dl	
380	尿糖(一日)	基準範囲	40 ~ 85	設定なし	
		単位	mg/day	g/day	
304	尿素窒素(血中)	項目名	U.N.	B.U.N.	測定感度の向上 項目名の見直し (13 頁)
		基準範囲	8.0 ~ 20.0mg/dl	8 ~ 20mg/dl	
		報告桁数	小数点以下第一位	整数	
386	尿素窒素(尿中)	項目名	ニョウ U.N.	ニョウ B.U.N.	項目名の見直し (13 頁)
2195	骨型 ALP (BAP)	検査方法	CLEIA	EIA	検査方法の見直し (50 頁)
		基準範囲	M 3.7 ~ 20.9	M 13.0 ~ 33.9	
			F 閉経前 2.9 ~ 14.5	F 9.6 ~ 35.4	
			閉経後 3.8 ~ 22.6		
		単位	μg/l	U/l	
		所要日数	2~3 日	3~7 日	
207	ASO(ASLO)	基準範囲	160 以下	40 ~ 160	報告単位の見直し (64 頁)
		単位	IU/ml	TODD	
205	CRP 定量	基準範囲	0.30 mg/dl 以下	0.5 mg/dl 以下	測定感度の向上 基準範囲の見直し (68 頁)
		報告桁数	小数点以下第二位	小数点以下第一位	
236	非特異的 IgE	基準範囲	202 IU/ml 以下	366 IU/ml 以下	試薬メーカーの新基準 範囲に変更 (69 頁)
672	CH-50	報告桁数	整数	小数点以下第一位	基準範囲桁数に準拠 (70P)


コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考 (検査案内掲載頁)
24	PT	基準範囲 PT-INR 値 の傾向	時間 10.0 ～ 13.0 秒	時間 9.8 ～ 11.9 秒	分析機・試薬の変更による基準範囲の見直し (87 頁)
			活性値 70 ～ 120 %	活性値 65 ～ 125 %	
			PT-INR 0.85 ～ 1.15	PT-INR 設定なし	
			PT-INR 相関図参照		
23	APTT	基準範囲	時間 23.0 ～ 35.0 秒	時間 25.0 ～ 35.0 秒	分析機・試薬の変更による基準範囲の見直し (87 頁)
1579	D-ダイマー	データの傾向	相関図参照		分析機・試薬変更 (87 頁)
733	AT-Ⅲ	基準範囲	80 ～ 130 %	70 ～ 140 %	分析機・試薬の変更による基準範囲の見直し (88 頁)
734	PLG	基準範囲	80 ～ 130 %	70 ～ 120 %	
107	尿蛋白定量	基準範囲	濃度 10 mg/dl 以下 一日量 20 ～ 120	濃度 5 mg/dl 以下 一日量 0.02 ～ 0.12	基準範囲の見直し 報告単位の統一 (97 頁)
		単位	一日量 mg/day	一日量 g/day	

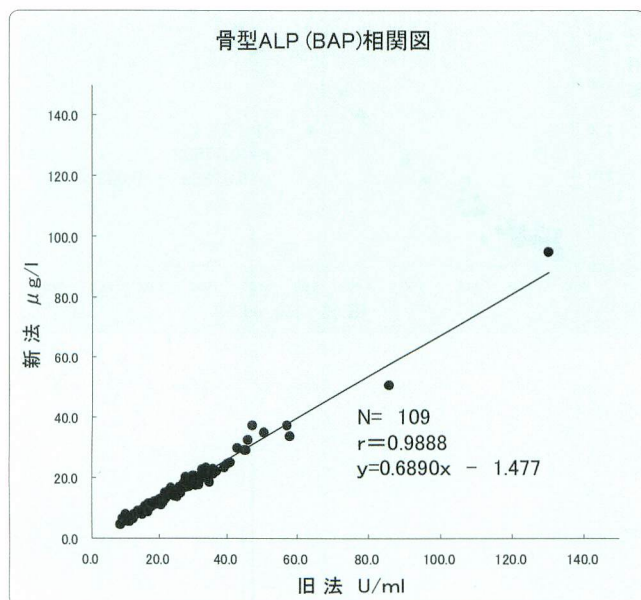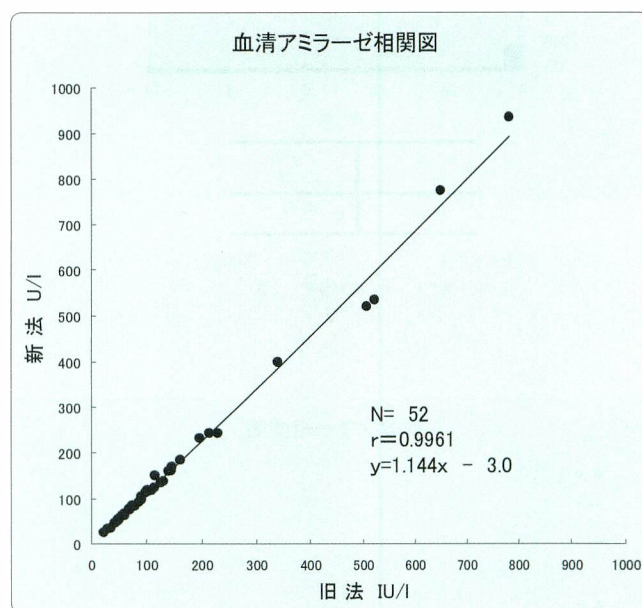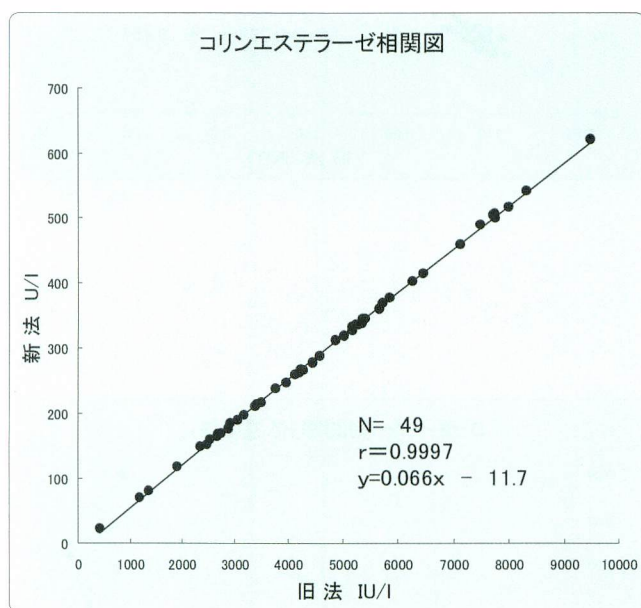

非特異的 Ig-E 参考基準範囲

スギ、ハルガヤ、カモガヤ、ブタクサ、ネコ上皮、ハウスダスト1、コナ
ヒョウヒダニ特異 IgE 陰性群


実数値分布

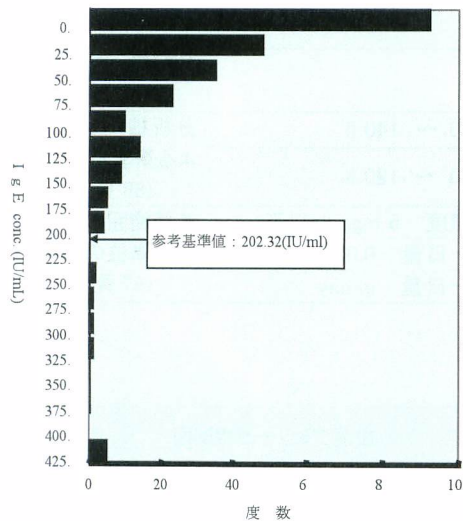


母集	全体
n	251
Mean	69.93

参考基準値 202 (IU/ml)
(ノンパラメトリック法 95%タイル値)

PT-INR相関図

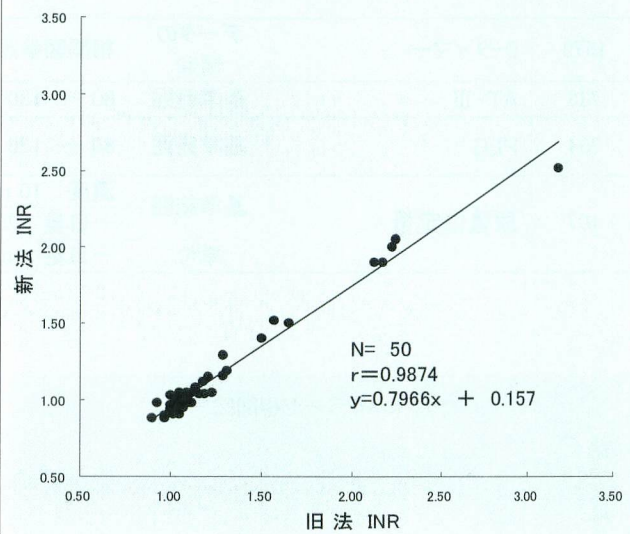

D-ダイマー相関図

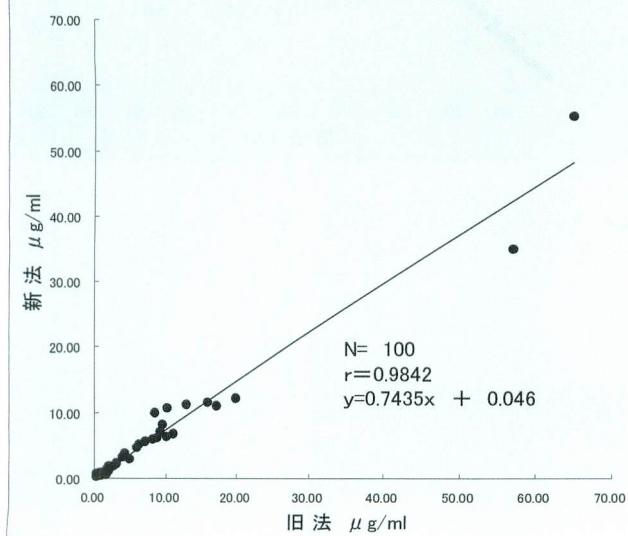

D-ダイマー相関図(低濃度域)

