

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

変更内容変更項目一覧

案内書頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
P.13	373	アミラーゼアイソザイム(血清)	検査方法	アガロース電気泳動法	セルロースアセテート膜電気泳動法	現測定試薬の製造販売中止にともない測定機器ならびに測定試薬を変更させていただきます。
			基準値(単位)	S 36.0 ~ 84.3 % P 15.7 ~ 64.0 %	S 35 ~ 79 % P 21 ~ 65 %	
			報告範囲	0.0 ~ 100.0	0 ~ 100	
	393	アミラーゼアイソザイム(尿)	検査方法	アガロース電気泳動法	セルロースアセテート膜電気泳動法	
			基準値(単位)	S 17.7 ~ 61.3 % P 38.7 ~ 82.3 %	S 12 ~ 59 % P 41 ~ 88 %	
			報告範囲	0.0 ~ 100.0	0 ~ 100	


変更期日

- 平成 27 年 1 月 5 日(月) 受付日分より

アミラーゼアイソザイム

本検査におきまして、現測定試薬の製造販売中止にともない測定機器および測定試薬の変更をさせていただきます。併せて、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。基準値はメーカー設定値です。

新旧二法の相関

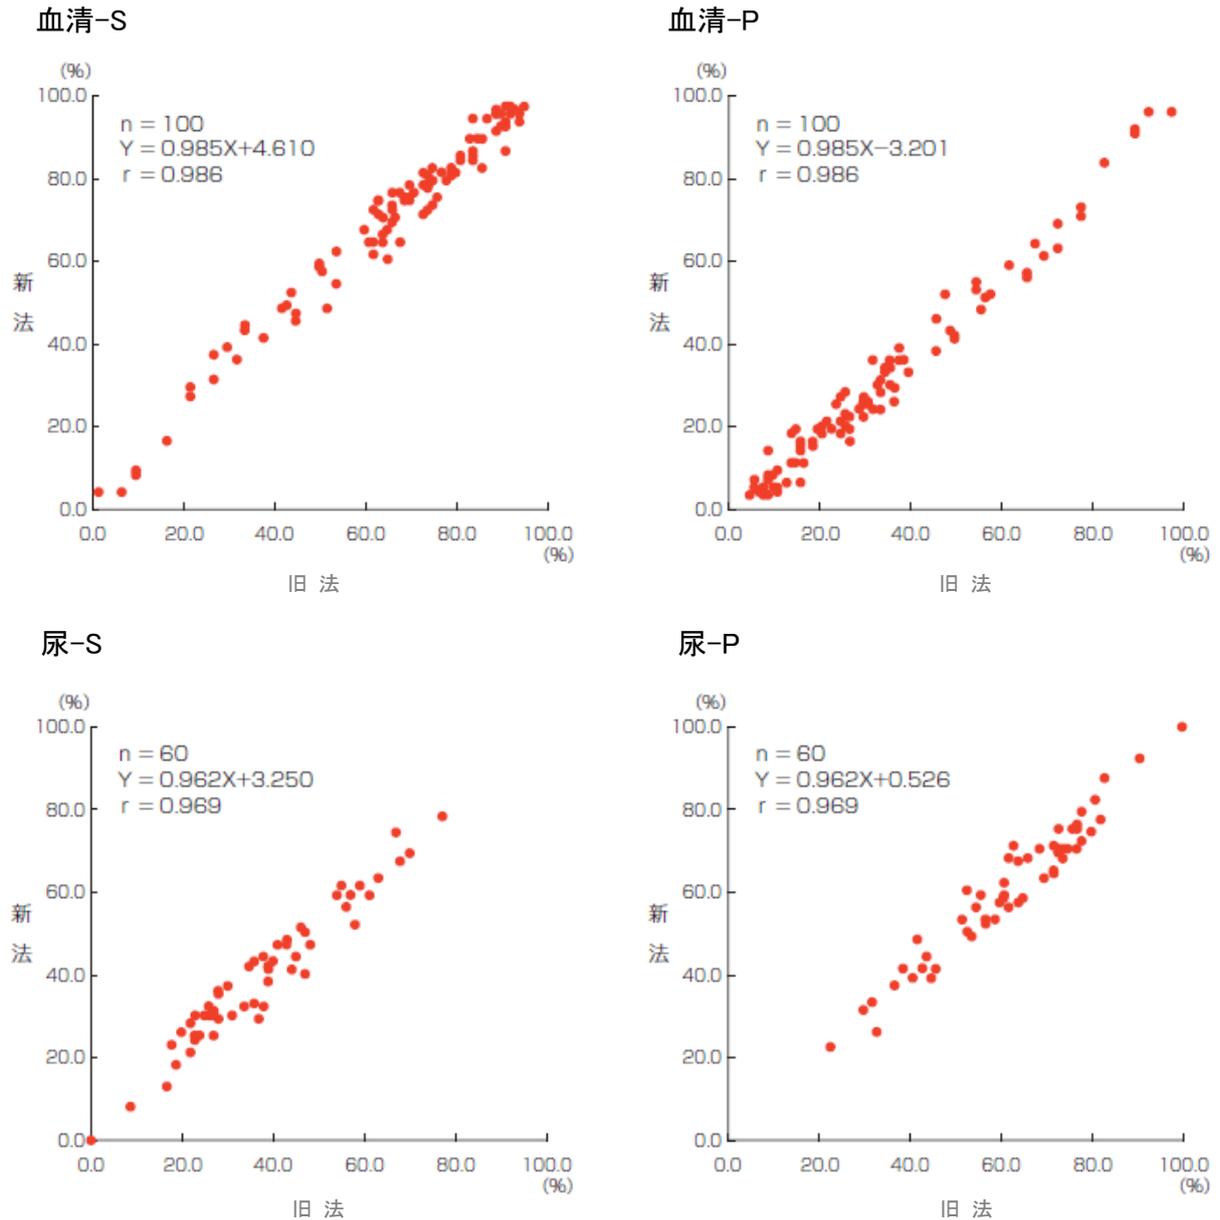

(SRL 検討データ)

□参考文献

星野 忠 : JJCLA 37(3) : 293~297, 2012.