

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目の現行試薬販売中止に伴い、新試薬に変更させていただきますので取り急ぎご案内申し上げます。

なお、併せて基準値をメーカー推奨値に基づき変更致します。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目

- 2151 抗 GAD 抗体
- 1629 抗 Jo-1 抗体

### 変更内容

案内書掲載頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
44	2151	抗 GAD 抗体	検査方法	ELISA	RIA
			基準値	5.0 未満 U/mL	1.5 未満 U/mL
72	1629	抗 Jo-1 抗体	検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値	10.0 未満 U/mL	10.0 以下 U/mL
			備考	不活化(非働化)検体ではデータに影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	記載なし

### 変更期日


- 平成 27 年 12 月 17 日(木)

裏面をご覧ください

## 新旧二法の相関

---

### 【抗 GAD 抗体】

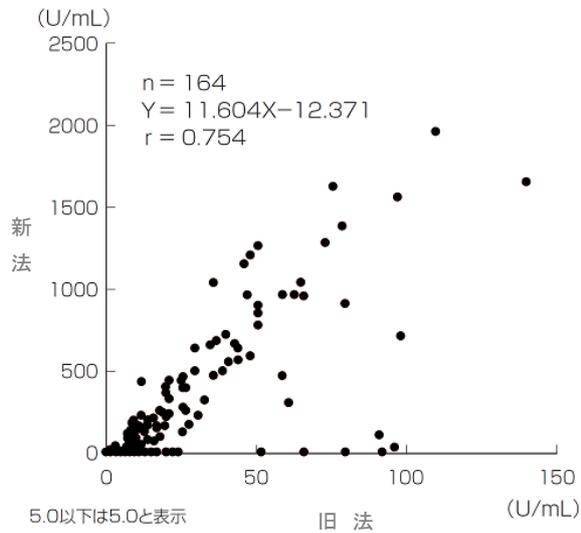


### □参考文献

及川 洋一, 他 : 医学と薬学 72 (9) : 1551~1560, 2015.

---

### 【抗 Jo-1 抗体】

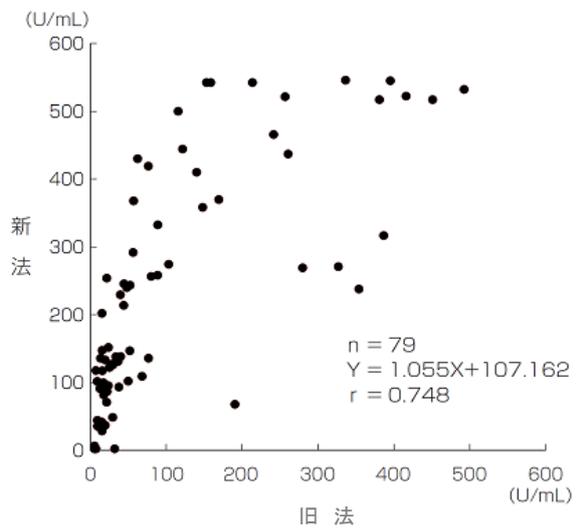

### □参考文献

松下 雅和, 他 : 医学と薬学 70 (1) : 109~117, 2013.

---