

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の対象項目につきまして検査内容を変更致しますので取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

- 556 11-ヒドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)
- 3120 HCV-RNA 定量《TaqManPCR 法》
- 3121 HIV-1 RNA 定量《TaqManPCR 法》

変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考 (総合検査のご案内)
556	11-ヒドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)	検査委託先	エスアールエル	LSIメディエンス	検査委託先の変更 42頁
		基準値	7.0~23.0 μg/dL (午前10時採血)	8.0~30.0 μg/dL (午前8時~10時採血)	
		検体量	0.5 mL	1.2 mL	
3120	HCV-RNA定量《TaqManPCR法》	検査方法	ロシュ/リアルタイムRT-PCR法 [ロシュ・ダイアグノスティックス]	ロシュ/リアルタイムRT-PCR法 [ロシュ・ダイアグノスティックス]	自動測定装置変更に伴う改良試薬の採用 60頁
3121	HIV-1 RNA定量《TaqManPCR法》	検査方法	ロシュ/リアルタイムRT-PCR法 [ロシュ・ダイアグノスティックス]	ロシュ/リアルタイムRT-PCR法 [ロシュ・ダイアグノスティックス]	自動測定装置変更に伴う改良試薬の採用 61頁
		検体量	EDTA-2K血漿 2.1 mL	EDTA-2K血漿 3.5 mL	


変更期日

- 平成 29 年 3 月 31 日(金) 受付日分より

HCV-RNA 定量《TaqManPCR 法》

自動測定装置の変更に伴い、HCV-RNA定量《TaqManPCR法》の測定試薬を同一メーカーが販売する改良試薬に変更します。

新旧二法の相関

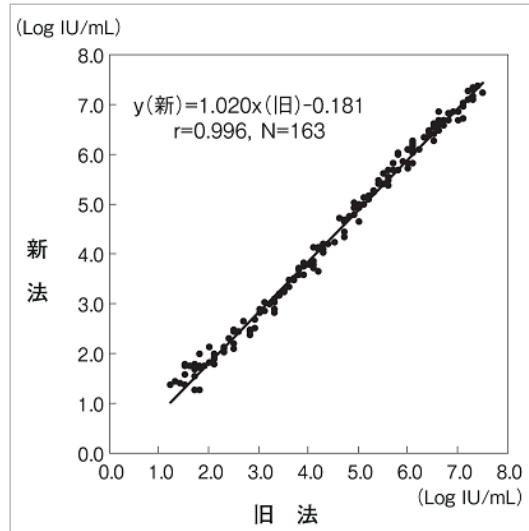

(LSI メディエンス検討データ)


□参考文献

菅原昌章, 他: 医学と薬学 **73**, 1329-1339, 2016.

HIV-1 RNA 定量《TaqManPCR 法》

自動測定装置の変更に伴い、HIV-1 RNA定量《TaqManPCR法》の測定試薬を同一メーカーが販売する改良試薬に変更します。本変更に伴い、検体量の削減が可能になりました。

新旧二法の相関

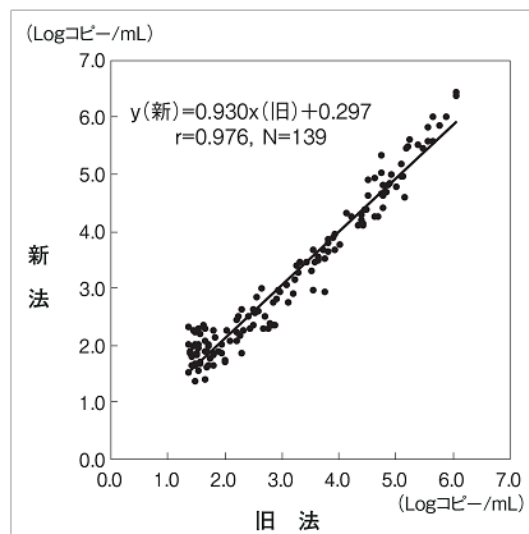

(LSI メディエンス検討データ)

□参考文献

目崎和久, 他: 医学と薬学 **73**, 705-709, 2016.