

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更致しますので取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 検査内容変更

コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考
2327	EBV-DNA 解析	検査項目名 基準値	EBV-IR3 領域 検出せず	EBV-DNA 解析 (-)	検査項目名の 見直し 基準値表記の 適正化
3241	bcl-2/J <sub>H</sub> キメラ 遺伝子微小	検査項目名 基準値	bcl-2/J <sub>H</sub> 再構成 検出せず	bcl-2/J <sub>H</sub> キメラ 遺伝子微小 (-)	
1608	HTLV-1px 遺伝子	基準値	検出せず	(-)	基準値表記の 適正化
2864	BCL-1 微小 残存検出	基準値	検出せず	(-)	
3089	JAK2V617F 変異解析	基準値	検出せず	(-)	
3627	RAS 遺伝子 変異解析	基準値	変異陰性		
3639	c-kit 遺伝子変異 (GIST)	基準値	検出せず		
3663	血漿 EGFR 遺伝子変異	基準値	検出せず		
3679	BRAF 遺伝子 変異解析	基準値	検出せず	(-)	
3730	PDGFR $\alpha$ 遺伝子 変異(GIST)	基準値	検出せず		

\*裏面もご参照下さい。





### 変更期日

- 平成 29 年 4 月 1 日(土)受付分より

# 検査内容変更

コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考
1165	IgG サブクラス	検査方法 基準値	免疫比濁法および ラテックス免疫比濁法 IgG1 351~962 IgG2 239~838 IgG3 8.5~140 IgG4 4.5~117 (mg/dL)	ネフェロメトリー IgG1 320~748 IgG2 208~754 IgG3 6.6~88.3 IgG4 4.8~105 (mg/dL)	高感度試薬の 採用
1796	IgG1	検査方法 基準値	免疫比濁法および ラテックス免疫比濁法 351~962 (mg/dL)	ネフェロメトリー 320~748 (mg/dL)	
1798	IgG3	検査方法 基準値	免疫比濁法および ラテックス免疫比濁法 8.5~140 (mg/dL)	ネフェロメトリー 6.6~88.3 (mg/dL)	

## ▶ 現法と新法の比較

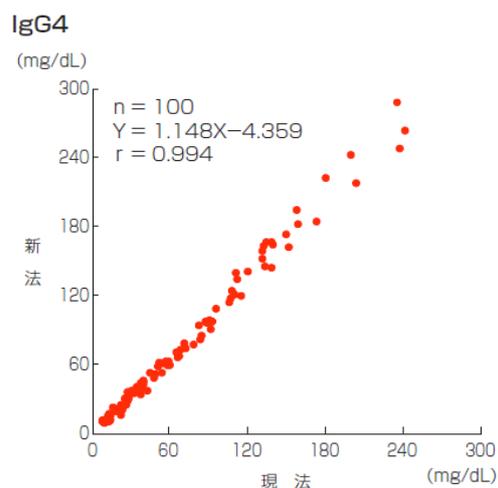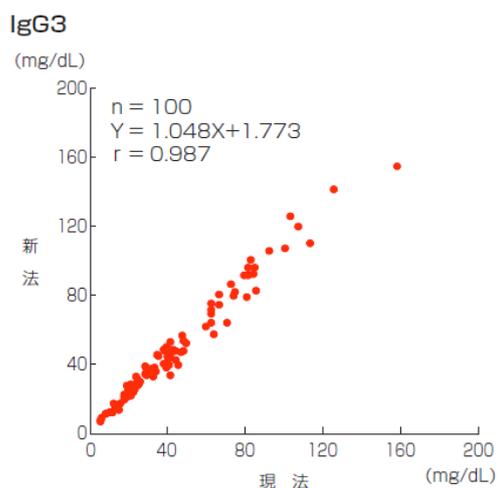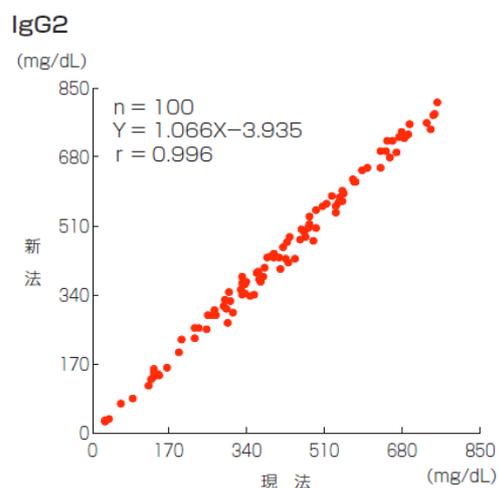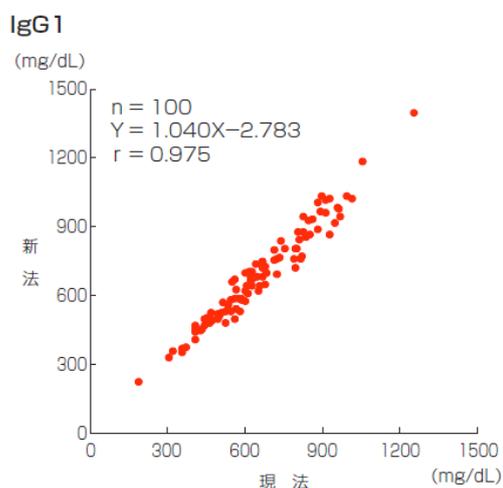

(SRL 検討データ)