

IgG4 に関するお知らせ - 試薬変更に伴う高濃度域データの高値化 -

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、委託先の株式会社エスアールエルより下記の連絡を受けましたので、ご案内申し上げます。

IgG4 試薬につきまして、250mg/dL 以上の高濃度域では、現試薬は旧試薬と比べ約25%高値傾向となることが判明しました。

受託開始当初はデータ差を認識しておりませんでした。ご指摘を受け高濃度域の検証を行ったところ、データに差があることを確認しました。


原因は、試薬検証時と受託開始後の希釈方法の違いによるものでした。

以上の事を鑑みて、継続的にご依頼されている場合には、データ傾向にご留意いただきますよう、お願いいたします。

謹白

記

■ 現法【1799:IgG4(LA)】および旧法の比較

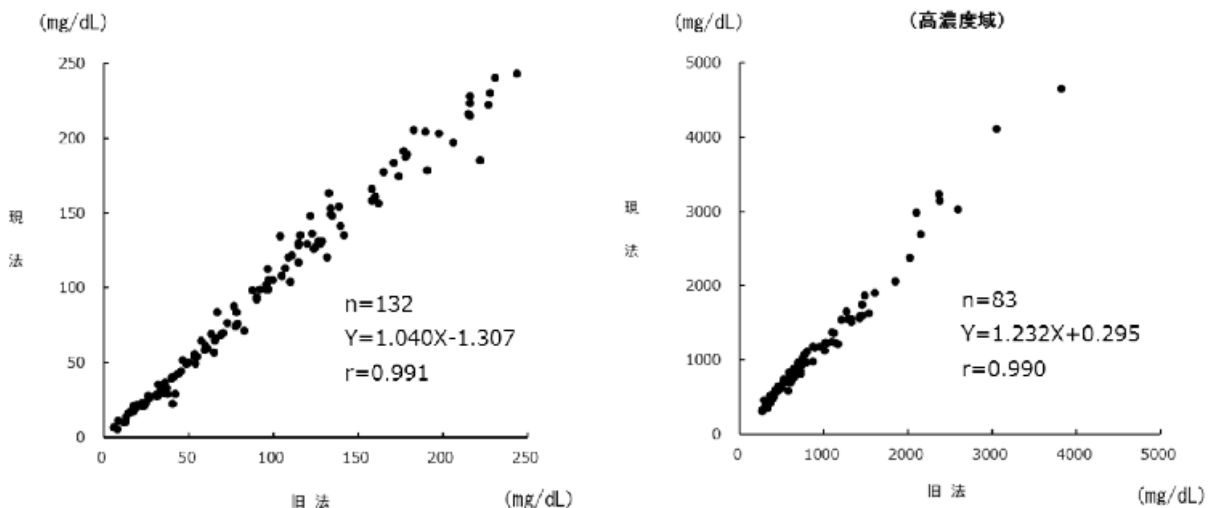

(2019-03 内容変更のお知らせより再掲載 2019年3月2日(土)受付日分より)

- 高濃度域データにおける新旧試薬のデータについて、ご不明な点がございましたら、弊社営業員までお申し付け下さい。
- 基準値付近のデータは良好な相関を示しております。