

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、現行試薬販売中止に伴い測定試薬を変更させていただきます。
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

項目コード	検査項目	変更点	新	旧	検査案内 掲載頁
23	活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APTT)	測定試薬	レボヘム APTT SLA	トロンボチェック APTT	P. 87


※ 基準値の変更はございません。

- 新試薬は、ヘパリン、ループスアンチコアグラント(LA)に対する感受性が高く、旧試薬と比較し秒数が延長する可能性があります。
- 旧試薬ではアミノグリコシド系抗生物質の影響を受けて秒数が延長を示すことがありましたが、新試薬では影響を受けにくくなっております。

変更日

- 令和7年4月1日(火)受付分より

相関性

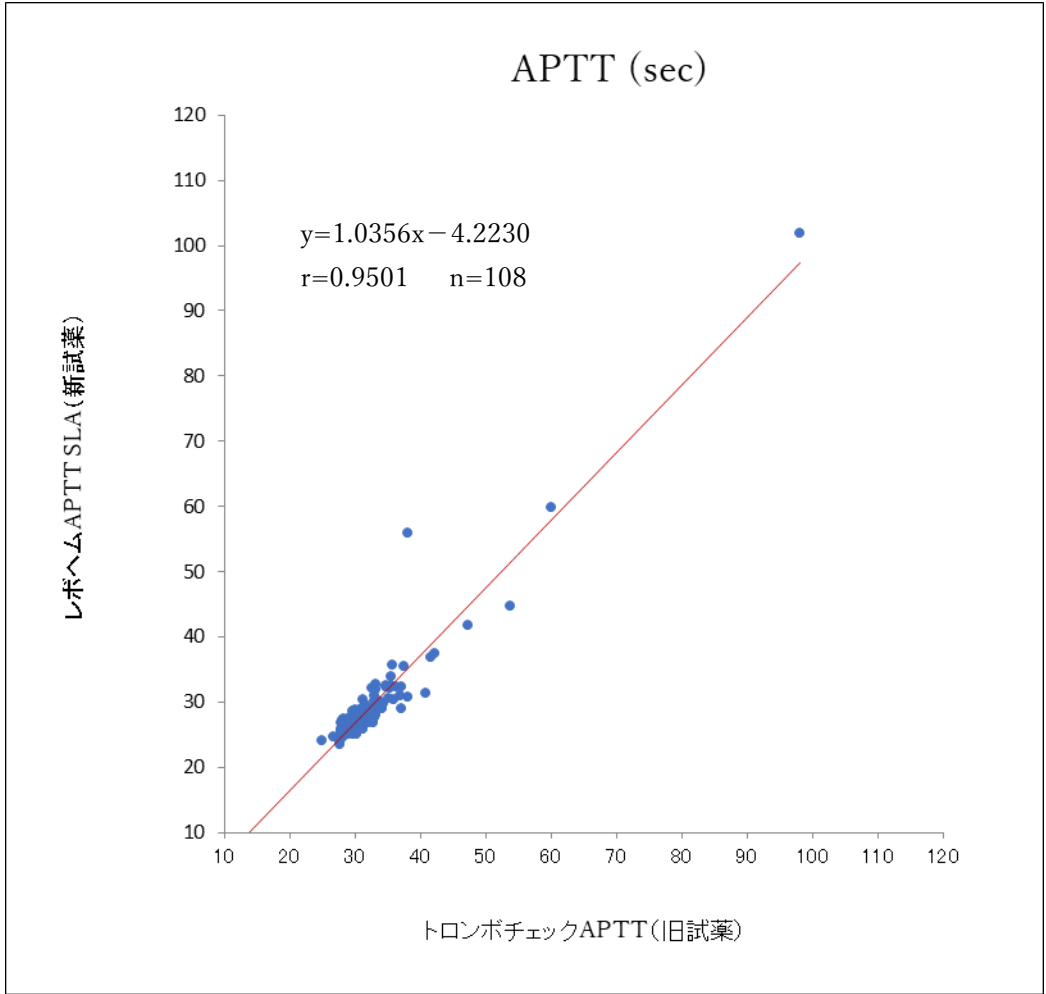

※社内検討データ