

「タクロリムス」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、標記項目の測定委託先(株式会社エスアールエル セントラルラボラトリー)より、検査内容を変更する旨の連絡を受けましたのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考 (検査案内掲載頁)
1360	タクロリムス	検査方法	CLEIA	ECLIA	測定試薬変更に伴う、検査方法、報告範囲、報告桁数の変更 保存(安定性)を追記 ※詳細については裏面をご参照ください (P.33)
		基準値 (単位)	なし(ng/mL)	同左	
		保存 (安定性)	凍結(21日)	凍結	
		報告範囲	0.50未満、 0.50~79.9、80.0以上	0.50未満、 0.50~99900000	
		報告桁数	有効3桁、整数2桁、小数2桁	有効3桁、整数8桁、小数2桁	

変更期日


- 令和7年3月31日(月)受付日分より

●タクロリムス


エスアールエル検討データ

●相関図


(全体)

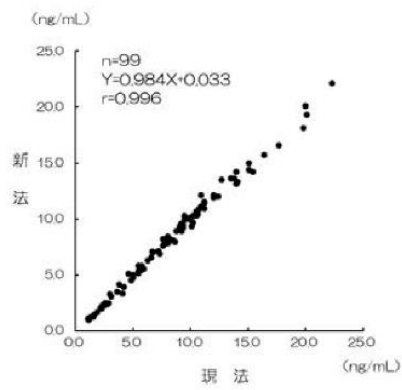

(低濃度域)

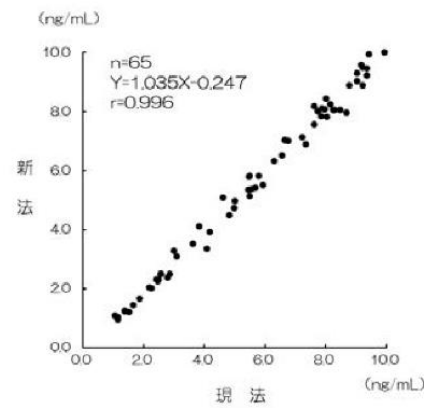

(新法とLC-MS/MS)

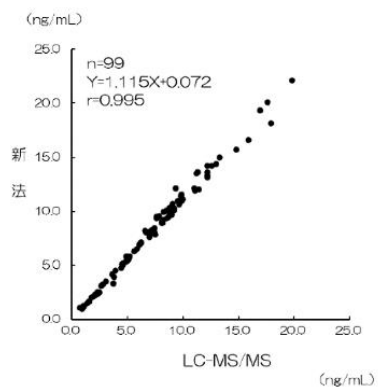

●参考文献

岡崎 一幸, 他: 医学と薬学 79(8):1109~1116, 2022.